



22

8590

环

委检

仙桃绿

(松



华正
HUA ZHENG
环境工程

一、任

受仙
4月8日
并于202

二、企

垃圾
及焚烧

辅
助净化

三、监

监测类


废气在
北对监测

四、样

校正
JAZHENG
TES

五、检测项目、分析方法

类别	监测项目	分析方法	监测频率
废气	颗粒物	重量法	1次/月
	二氧化硫	定电位	1次/月
	氮氧化物	定电位	1次/月
	氨	定电位	1次/月
	氯化氢	定电位	1次/月
	氟化氢	定电位	1次/月
	氯气	定电位	1次/月
	氰化氢	定电位	1次/月
	一氧化碳	定电位	1次/月
	二氧化碳	定电位	1次/月
废水	化学需氧量	重铬酸钾法	1次/月
	生化需氧量	五日培养法	1次/月
	氨氮	纳氏试剂法	1次/月
	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	1次/月
	总磷	钼钼蓝法	1次/月
	铜	原子吸收分光光度法	1次/月
	铅	原子吸收分光光度法	1次/月
	镉	原子吸收分光光度法	1次/月
	铬	原子吸收分光光度法	1次/月
	汞	冷原子荧光法	1次/月

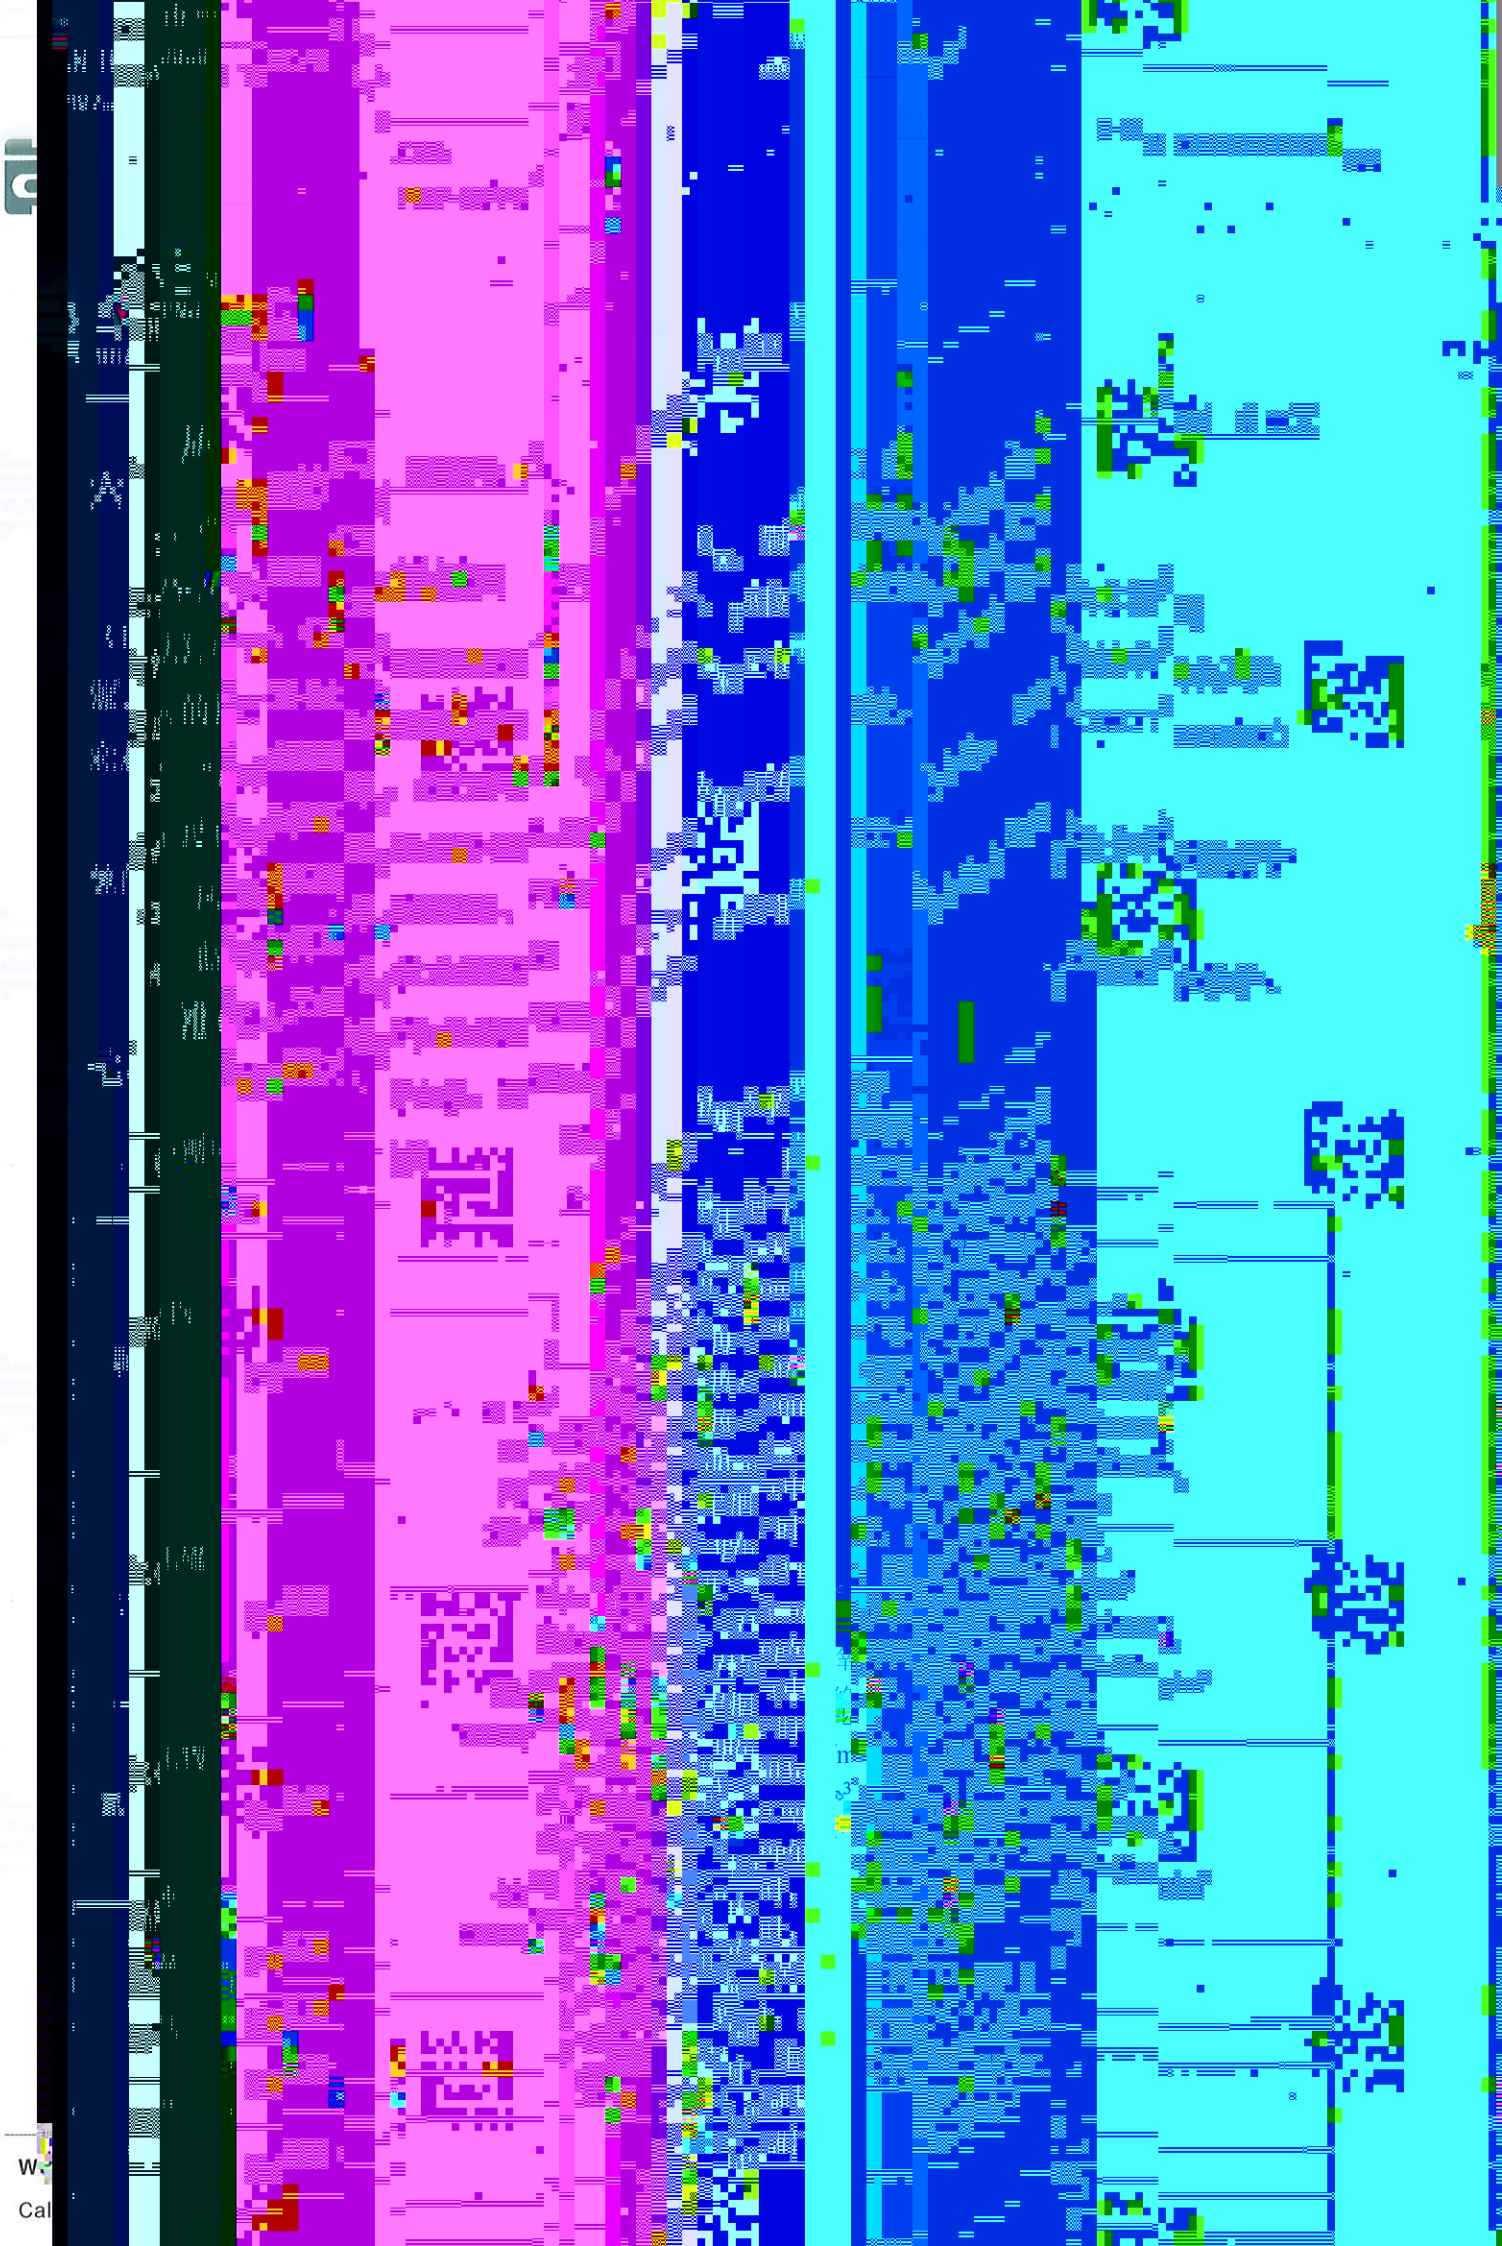

[illegible]

4

编号: 式

一流速上

13:56

14:35

15:05

匀一
值

吴差

吴差

10:10

10:40

11:20

值

吴差

吴差

1-2、

监测点

DA002
气筒

比对
结果

DA003
气筒

比对
结果

2、

监

DA
排
(C

比
结

DA
排
(C

比
结

备注



1

HV

3

出

D

CC

D

A0

出

CC

E-mail : hz@hztesting.com

第8页 共 11 页

数据对差=B--A

-0.5

-0.7

-0.7

-0.6

-0.8

-1.6

氧气技术要求

相对准确度≤15%

-0.8

0.2

-1.1

-1.2

-1.0

-1.5

氧气技术要求

相对准确度≤15%

NU
HAN HU
Cal
1: 027-8
AZHE
79685
90



4、污染源

监测点

DAC002(2#排
筒)(◎1)

对比监测结果


样品类型

监测点

DAC003(1#排
筒)(◎2)

对比监测结果

备注: ND表示

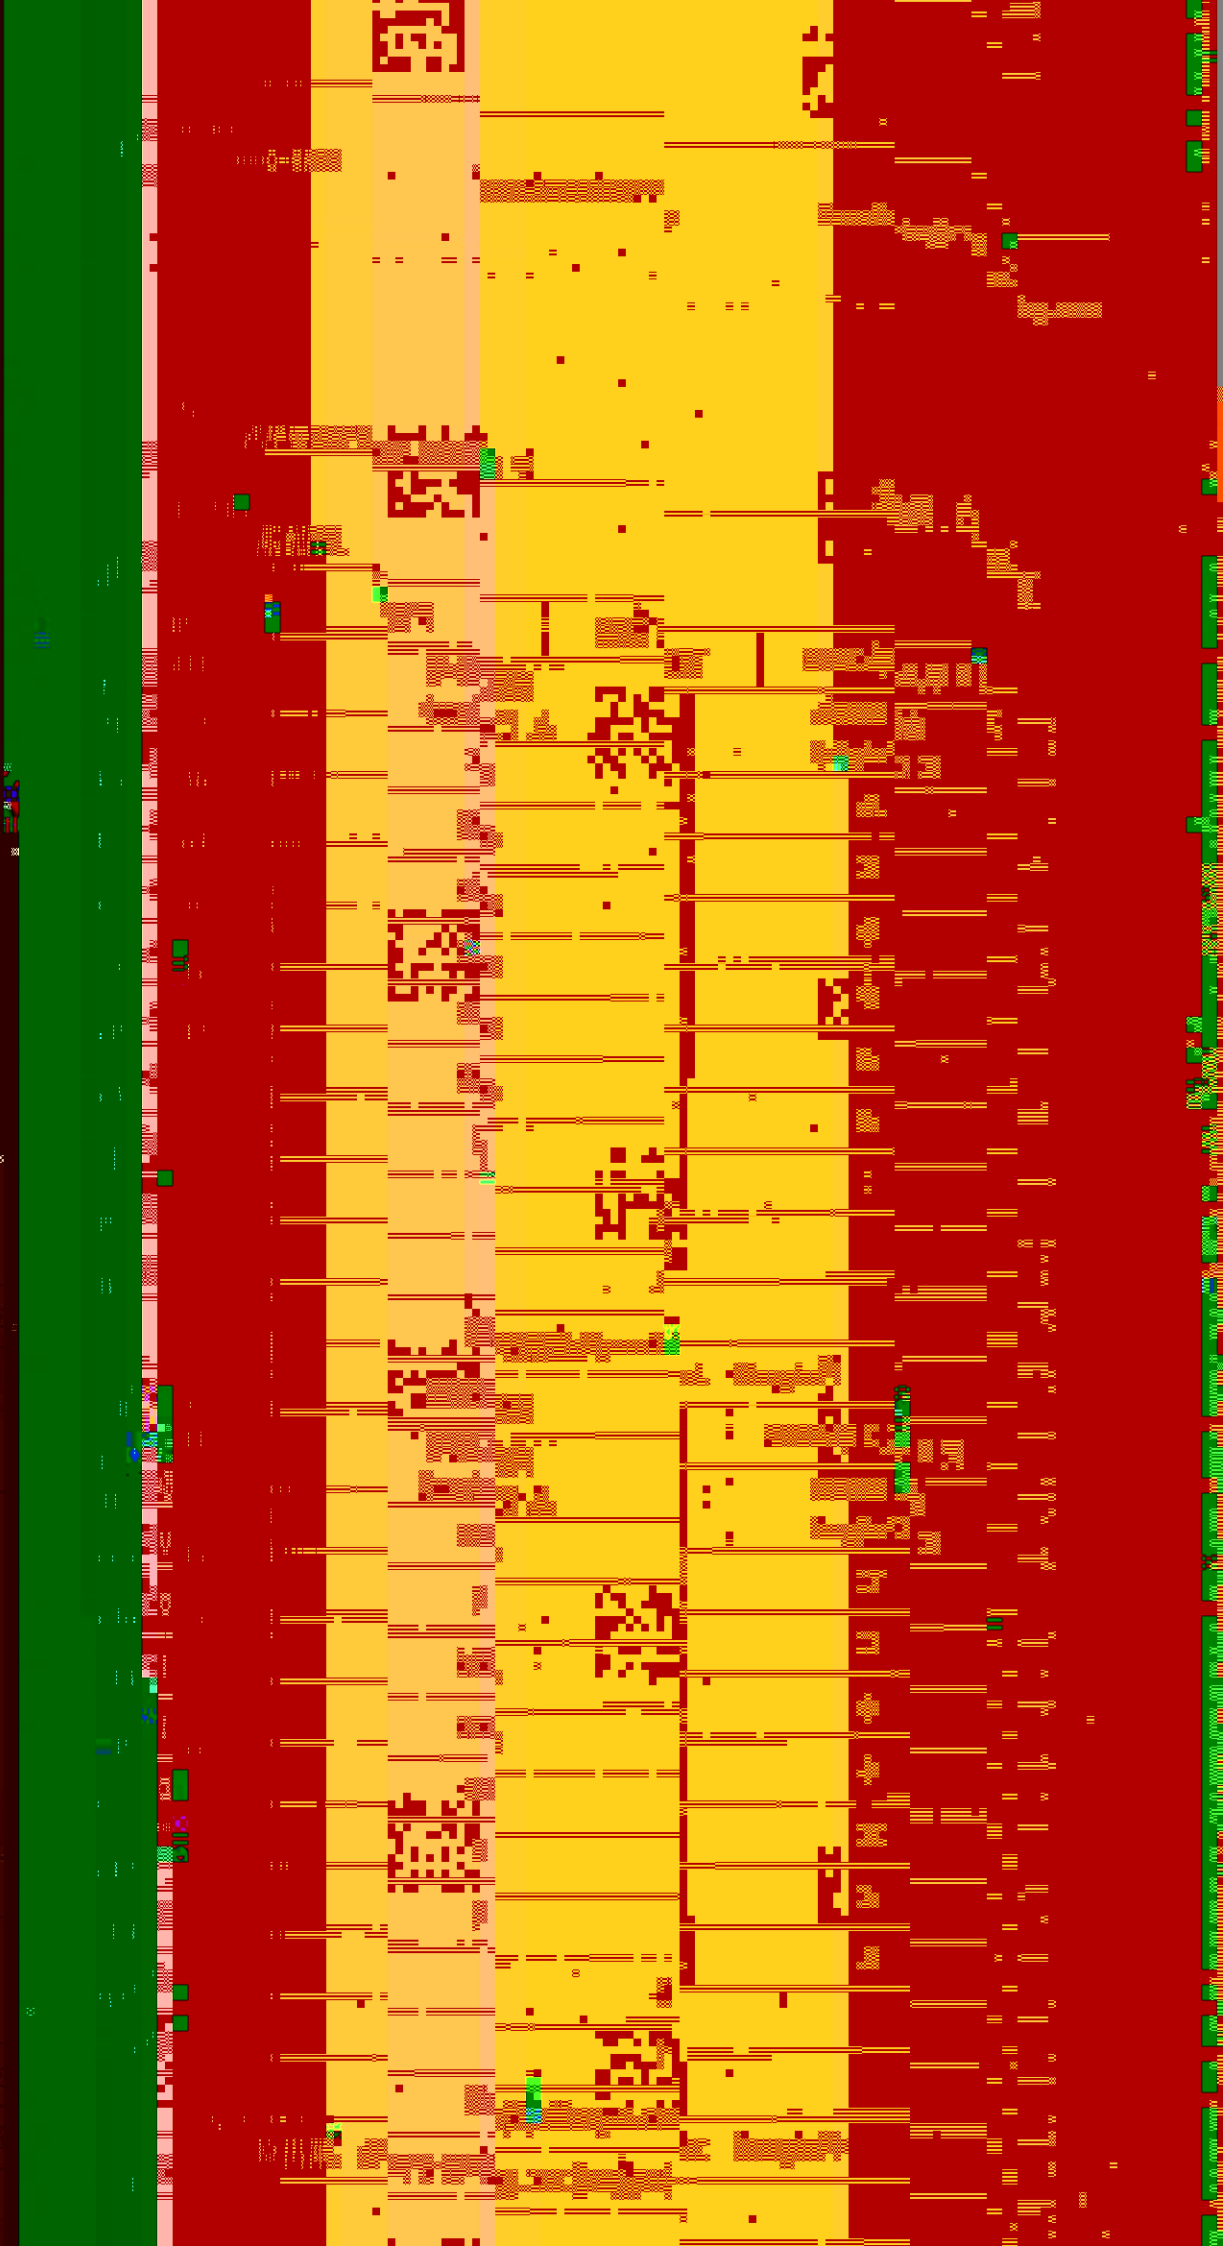





报告编号

：武华委检

九

比对监测结论

监测结果表明：
本次比对监测结果均合格。#排气筒

DA 002(2

均合

张

024.

8

字 202

(01)

**报告

hzttest
ing.com

页 11 页

监测系

编制

日

人：李静妮
期：2024.4.25

审核人：

日期：2

WUHAN

Call : 027-

HAZHENG TESTING

CO., LTD.

7968590

TD.

CO., LTD.

Fax : 027-8